

⑩ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Patentschrift
⑪ DE 23 66 274 C 2

⑥ Int. Cl. 9:
G 07 D 7/00

⑰ Aktenzeichen: P 23 66 274.0-53
⑱ Anmeldetag: 25. 4. 73
⑳ Offenlegungstag: 15. 11. 73
㉑ Veröffentlichungstag: 9. 9. 82

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

③① Unionspriorität: ③② ③③ ③④
03.05.72 AT A3824-72

⑦③ Patentinhaber:
GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH,
8000 München, DE

⑤② Teil aus: P 23 20 731.0

⑦② Erfinder:
Stenzel, Gerhard, Dr.; Lehle, Erhard, Dipl.-Ing., 8000
München, DE

⑤⑤ Entgegenhaltungen:
DE-OS 17 74 291
DE-OS 20 07 903
DE-OS 20 37 755

⑤④ Prüfgerät zum Prüfen der Echtheitsmerkmale in Wertpapieren oder dergleichen

DE 23 66 274 C 2

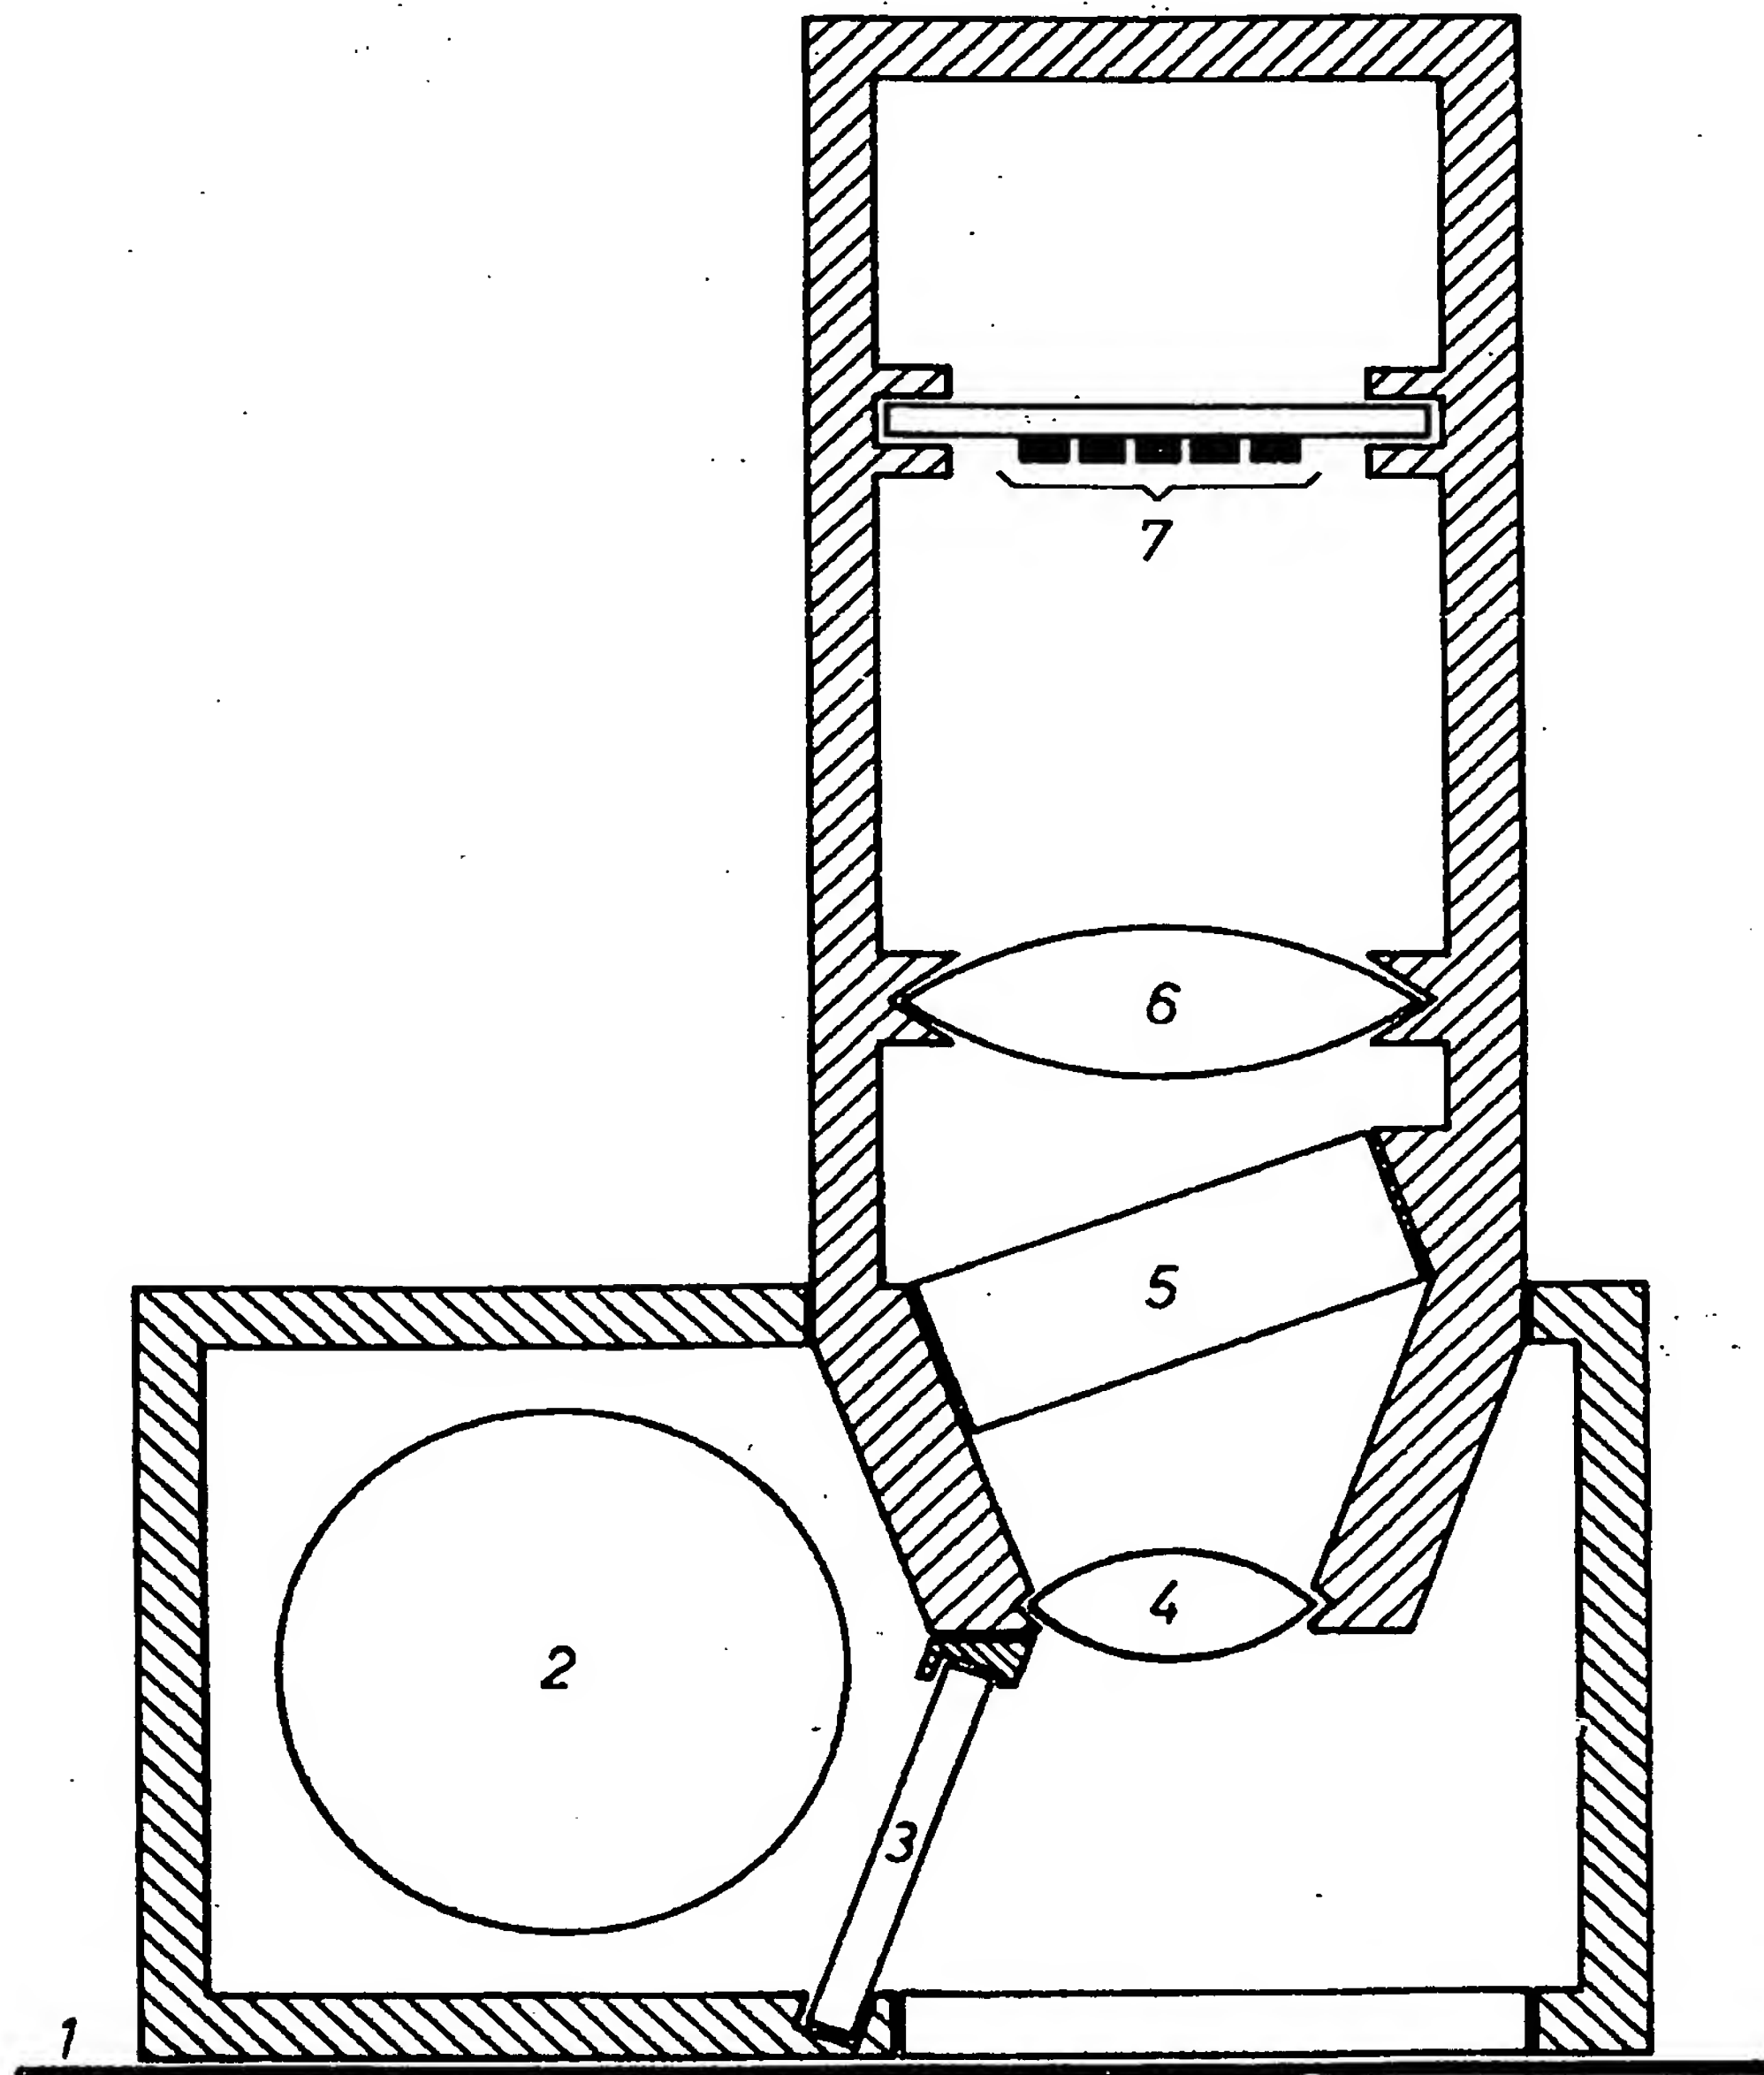


Fig. 1

Patentansprüche:

1. Prüfgerät zur Prüfung der Echtheitsmerkmale in Wertpapieren oder dergleichen, die aus fluoreszierenden Stoffen bestehen, welche Stoffe im angeregten Zustand in für die Echtheit des Wertpapiers charakteristischen Emissionsspektren mit dicht beieinanderliegenden Maxima und Minima im ultraviolett, sichtbaren oder infraroten Spektralbereich fluoreszieren und bei dem das aufgefächerte Fluoreszenzspektrum auf im Strahlengang fest angeordnete Fotozellen projiziert wird, dadurch gekennzeichnet, daß ein hoch auflösendes Spektralfotometer mit einer geeigneten Anregungsenergiequelle und einem Dispersionselement vorgesehen ist, bei dem im Strahlengang pro zu erfassenden Spektralbereich jeweils mehrere Fotozellen derart angeordnet sind, daß die Maxima und Minima des jeweiligen Spektralbereiches mit separaten Fotozellen erfassbar sind, und daß ein Vergleichsvorgang vorgesehen ist, mit dem die Werte der Fotozellensignale eines Spektralbereiches miteinander vergleichbar sind.

2. Prüfgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Dispersionselement ein schräggelagertes schmalbandiges Interferenzfilter angeordnet ist.

3. Prüfgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Differenzwerte zwischen den Maxima und Minima als Meßwert dienen, die mit Sollwerten verglichen werden.

4. Prüfgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Quotientenwerte der Maxima und Minima als Meßwerte dienen und daß zu zulässige Toleranzbereiche für die Quotienten mittels Spannungsteilern einstellbar ist.

Die Erfindung bezieht sich auf ein Prüfgerät zur Prüfung von Echtheitsmerkmalen in Wertpapieren und dergleichen. Unter Wertpapier sollen dabei alle Papiere oder andere Informationsträger verstanden werden, die unabhängig von ihrem materiellen Wert einen ideellen Wert repräsentieren und deren Nachahmung durch Unbefugte in möglichst hohem Maße erschwert werden muß. Wertpapiere in diesem Sinne sind Banknoten, Aktien, Schecks, Urkunden, Ausweise, Kreditkarten, Verträge, ja sogar Kunstwerke.

Zur Fälschungssicherung von Wertpapieren ist es bekannt, in dem Papier Sicherheitsmerkmale, wie Sicherheitsfäden, Wasserzeichen, fluoreszierende Stoffe und dergl. vorzusehen, wobei man im wesentlichen darauf achtet, daß die Nachahmung der Sicherheitsmerkmale nur mit großem Aufwand möglich ist, damit gegebenenfalls der Aufwand größer und teurer ist als der durch das Papier repräsentierte Wert.

Das Prüfgerät gemäß der Erfindung soll dazu dienen, Fluoreszenz-Sicherheitsmerkmale zu prüfen und zu identifizieren, wobei die entsprechenden Fluoreszenzstoffe im angeregten Zustand im sichtbaren, ultravioletten oder infraroten Spektralbereich strahlen. Diese Spektren lassen nämlich durch Erfassen von Emissions-Dubletten eine eindeutige Identifikation dieser Substanzen und beliebiger Gemische davon zu. Da viele dieser Substanzen farblos sind, können sie mit bloßem Auge

nicht wahrgenommen werden, so daß die markierten Stellen nicht ohne weiteres zu erkennen sind.

Die Erfindung ergibt sich aus den Patentansprüchen.

Aus der DE-OS 17 74 291 ist es zwar bekannt, das von Banknoten remittierte Licht spektral zu zerlegen und mit fest angeordneten Fotozellen spektrale Anteile dieses Lichts zu erfassen; mit dieser Vorrichtung wird allerdings nur das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein spektraler Strahlungsanteile geprüft. Wegen der Verwendung von jeweils nur einer Fotozelle pro zu erfassenden Spektralbereich (pro Farbe oder Farbanteil) kann keine Aussage über charakteristische Eigenschaften dieser Strahlung, wie z.B. über die Schmalbandigkeit oder die Feinstruktur von Spektrallinien gemacht werden. Mit der bekannten Vorrichtung kann zwar das Vorliegen einer bestimmten Farbe in einer bestimmten Intensität festgestellt werden; die Unterscheidung unterschiedlicher gleicher Farben, wie z.B. breitbandiger und schmalbandiger Farben oder schmalbandiger Farben mit unterschiedlicher spektraler Struktur ist jedoch nicht möglich.

Es kann also bei der bekannten Vorrichtung nur allgemein das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein bestimmter Wellenlängen bzw. Wellenlängenbereiche festgestellt werden.

Dagegen gibt der Anspruch 1 die Lehre für diese Wellenlängen bzw. Wellenlängenbereiche die Maxima und die Minima auszuwählen und jeweils Maxima und Minima in Relation zu setzen.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Fig. 1 bis 5 näher beschrieben; es zeigt

Fig. 1 schematisch den Aufbau des Prüfgerätes,

Fig. 2 die geometrische Anordnung der Abtast-Fotozellen zur Identifizierung von Emissions-Linien-Dubletten,

Fig. 3 die Verstärkerschaltungen zur Verstärkung der Fotozellenströme,

Fig. 4 die Schaltung zur Bildung der Differenz zweier Fotozellenströme und

Fig. 5 die Schaltung zur Bildung des Quotienten zweier Fotozellenströme.

Das Prüfgerät besteht im wesentlichen aus einer Lichtquelle zur Beleuchtung des Wertpapiers und damit Anregung der Fluoreszenzsubstanz, einem Spektralfotometer mit einer Reihe nebeneinanderliegender Fotozellen zur Analyse der vom Wertpapier emittierten Strahlung sowie einer nachgeordneten elektronischen Schaltung zur Auswertung der Fotozellenströme, um eine Entscheidung echt oder falsch zu treffen und daraus Folgevorgänge auszulösen.

Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau des Prüfgerätes. Das Wertpapier 1 wird von einer Lichtquelle 2 beleuchtet. Als Lichtquelle dient — je nach der erforderlichen Anregungswellenlänge der fluoreszierenden Substanzen — eine Hoch- oder Niederdruck-Gasentladungslampe, eine Blitzlampe oder eine Glühbirne. Es kann aber auch eine Röntgenröhre, Elektrodenstrahlröhre oder eine radioaktive Substanz zur Anregung der Fluoreszenz verwendet werden. Wenn man optische Fluoreszenzanregung verwendet, so ist zwischen Lichtquelle und Wertpapier ein optisches Filter 3 angeordnet, welches störende Wellenlängen im Lampenlicht abblockt.

Der Kondensator 4 sammelt das emittierte Licht des fluoreszierenden Wertpapiers und bündelt es auf ein schräggelagertes, schmalbandiges Interferenzfilter 5. Bekanntlich ist die Wellenlänge der maximalen Transmission eines Interferenzfilters von dem Einfallswinkel

winkel des Lichtes abhängig. Je schräger der Lichteinfall, desto stärker verschieben sich die Wellenlängen des durchgelassenen Lichtes. Die Linse 6 fokussiert das durchgelassene Licht auf eine Anordnung gleichartiger Fotozellen 7 in der Brennebene von 6. Jede der Fotozellen wird nur von monochromatischem Licht getroffen. Dadurch mißt jede der Fotozellen die Fluoreszenzemission des Wertpapiers bei einer anderen Wellenlänge.

In Fig. 2 ist die geometrische Anordnung der Fotozellen gezeigt, mit der Emissions-Linien-Dublette identifiziert werden können. In dieser Anordnung messen die Fotozellen F_2 und F_4 die Lichtemission bei den Wellenlängen der Intensitätsmaxima, während die Fotozellen F_1 , F_3 und F_5 die Helligkeit des Untergrundes messen. Wenn also ein Wertpapier eine Substanz enthält, welche ein Emissionsspektrum nach Fig. 2 besitzt, so liefern die Fotozellen F_2 und F_4 kräftige Signale, während die Fotozellen F_1 , F_3 und F_5 keine Signale liefern.

Die elektronische Auswertung der Signale ist in Fig. 3 und 4 dargestellt.

Im Vorverstärker (Fig. 3) werden die Fotoströme der fünf Fotozellen mit Hilfe von Feldeffekttransistoren verstärkt. Dabei werden, um Bauteile zu sparen, die Fotoströme der Fotozellen F_1 , F_3 und F_5 addiert und gemeinsam verstärkt.

Im Vergleich (Fig. 4) wird mit Differenzverstärkern die Differenz der Fotoströme von den Fotozellen F_2 bzw. F_4 mit den Fotoströmen von F_1 , F_3 und F_5 gebildet. Dadurch wird geprüft, ob die beiden Intensitätsmaxima von Fig. 2 aus dem Untergrund herausragen. Sofern dies der Fall ist, erhält man am Ausgang A des Vergleichers einen positiven Spannungsstoß. Dieses Ausgangssignal läßt sich in bekannter Weise zur Steuerung von Relais oder zur Erzeugung von akustischen oder optischen Signalen weiterverarbeiten.

Die Differenzbildung hat noch den Vorteil, daß breitbandig emittierende Fluoreszenzsubstanzen, die den schmalbandig emittierenden Substanzen zur weiteren Fälschungssicherung beigemischt werden, den Nachweis der letzteren Substanzen nicht beeinflussen, da die zusätzlichen Substanzen nämlich lediglich in allen Fotozellen zusätzliche, etwa gleich große Fotoströme erzeugen, die bei der Differenzbildung eliminiert werden.

In Fig. 5 ist eine einfache Schaltung dargestellt, mit deren Hilfe nicht die Differenz, sondern der Quotient der Fotoströme zweier Fotozellen mit definierten Höchst- und Mindestwerten verglichen und zur Echtheitsfeststellung des Wertpapiers verwendet wird. Die Schaltung hat den Vorteil, größerer Sicherheit, da die Verschmutzung des Wertpapiers, Schwankungen der Lampenhelligkeit und Lagerungenauigkeit des Wertpapiers im Prüfgerät keinen Einfluß auf die Meßgenauigkeit besitzen.

Um Wechselstromverstärker einsetzen zu können, ist eine Lichtquelle verwendet, die periodische Helligkeits-

änderungen aufweist. Dadurch erhält man in beiden Fotozellen Wechselströme, deren Amplituden proportional zur Fluoreszenzemission bei den jeweils betrachteten Lichtwellenlängen sind (Gleichlicht kann in der gleichen Schaltung mit etwas aufwendigeren Gleichstromverstärkern verarbeitet werden). Die Fotoströme der beiden Fotozellen werden über die Klemmen A 1 und A 2 zu den Verstärkern V1 bzw. V2 geleitet, verstärkt, dann gleichgerichtet und zu den Komparatoren K_1 und K_2 geführt. An den Potentiometer P_1 und P_2 werden die zulässigen Maximal- und Minimalwerte des Quotienten der beiden Fotoströme eingestellt.

Zum besseren Verständnis der Quotientenbildung soll das Spannungsteilerverhältnis der beiden Potentiometer mit k_1 bzw. k_2 und die durch die Fotoströme hervorgerufenen Spannungen hinter den Gleichrichtern mit U_1 bzw. U_2 bezeichnet werden. Falls

$$U_1 < k_1 \cdot U_2$$

und

$$U_1 > k_2 \cdot U_2$$

so erhält man am Ausgang beider Komparatoren eine positive Spannung und damit auch am Ausgang des »UND«-Gatters C eine positive Spannung. Obige Beziehung läßt sich auch in der Form

$$k_2 < \frac{U_1}{U_2} < k_1$$

schreiben. Man erhält also dann und nur dann ein positives Ausgangssignal, falls der Quotient der beiden Fotoströme in dem für das Wertpapier charakteristischen Toleranzbereich liegt. Falls kein Licht auf die Fotozellen fällt, sind die Spannungen U_1 und U_2 jeweils null. In diesem Fall sorgt der hochohmige Widerstand R für eine kleine Nullpunktverschiebung von U_1 , wodurch verhindert wird, daß in einer Prüfapparatur ohne Wertpapier das Ausgangssignal »echt« auftreten kann.

In analoger Weise lassen sich die Signale von Fotozellenanordnungen auswerten, die zwei oder mehr Spektrallinsen ausmessen.

Es sind Interferenzfilter im Handel, die eine Halbwertsbreite von 1,5 Å besitzen. Mit derartigen Filtern lassen sich bis zu 10 Emissionslinien voneinander trennen.

Mit dem beschriebenen Gerät kann die Emission der fluoreszierenden Substanz nur in einem relativ engen Spektralbereich geprüft werden, da als Dispersionselement ein Interferenzfilter verwendet wird. Um Substanzen zu prüfen, zu deren Analyse ein größerer Spektralbereich notwendig ist, kann man selbstverständlich das gleiche Gerät verwenden, wenn man nur das Interferenzfilter durch ein Dispersions-Prisma oder -Gitter ersetzt. Derartige optische Anordnungen sind in Spektroskopen oder Spektralfotometern allgemein üblich. Auch bei der Verwendung von Dispersionsprismen oder Beugungsgittern kann die Spektralanalyse in der beschriebenen Anordnung durch mehrere Fotozellen gleichzeitig und ohne bewegte Teile erfolgen.

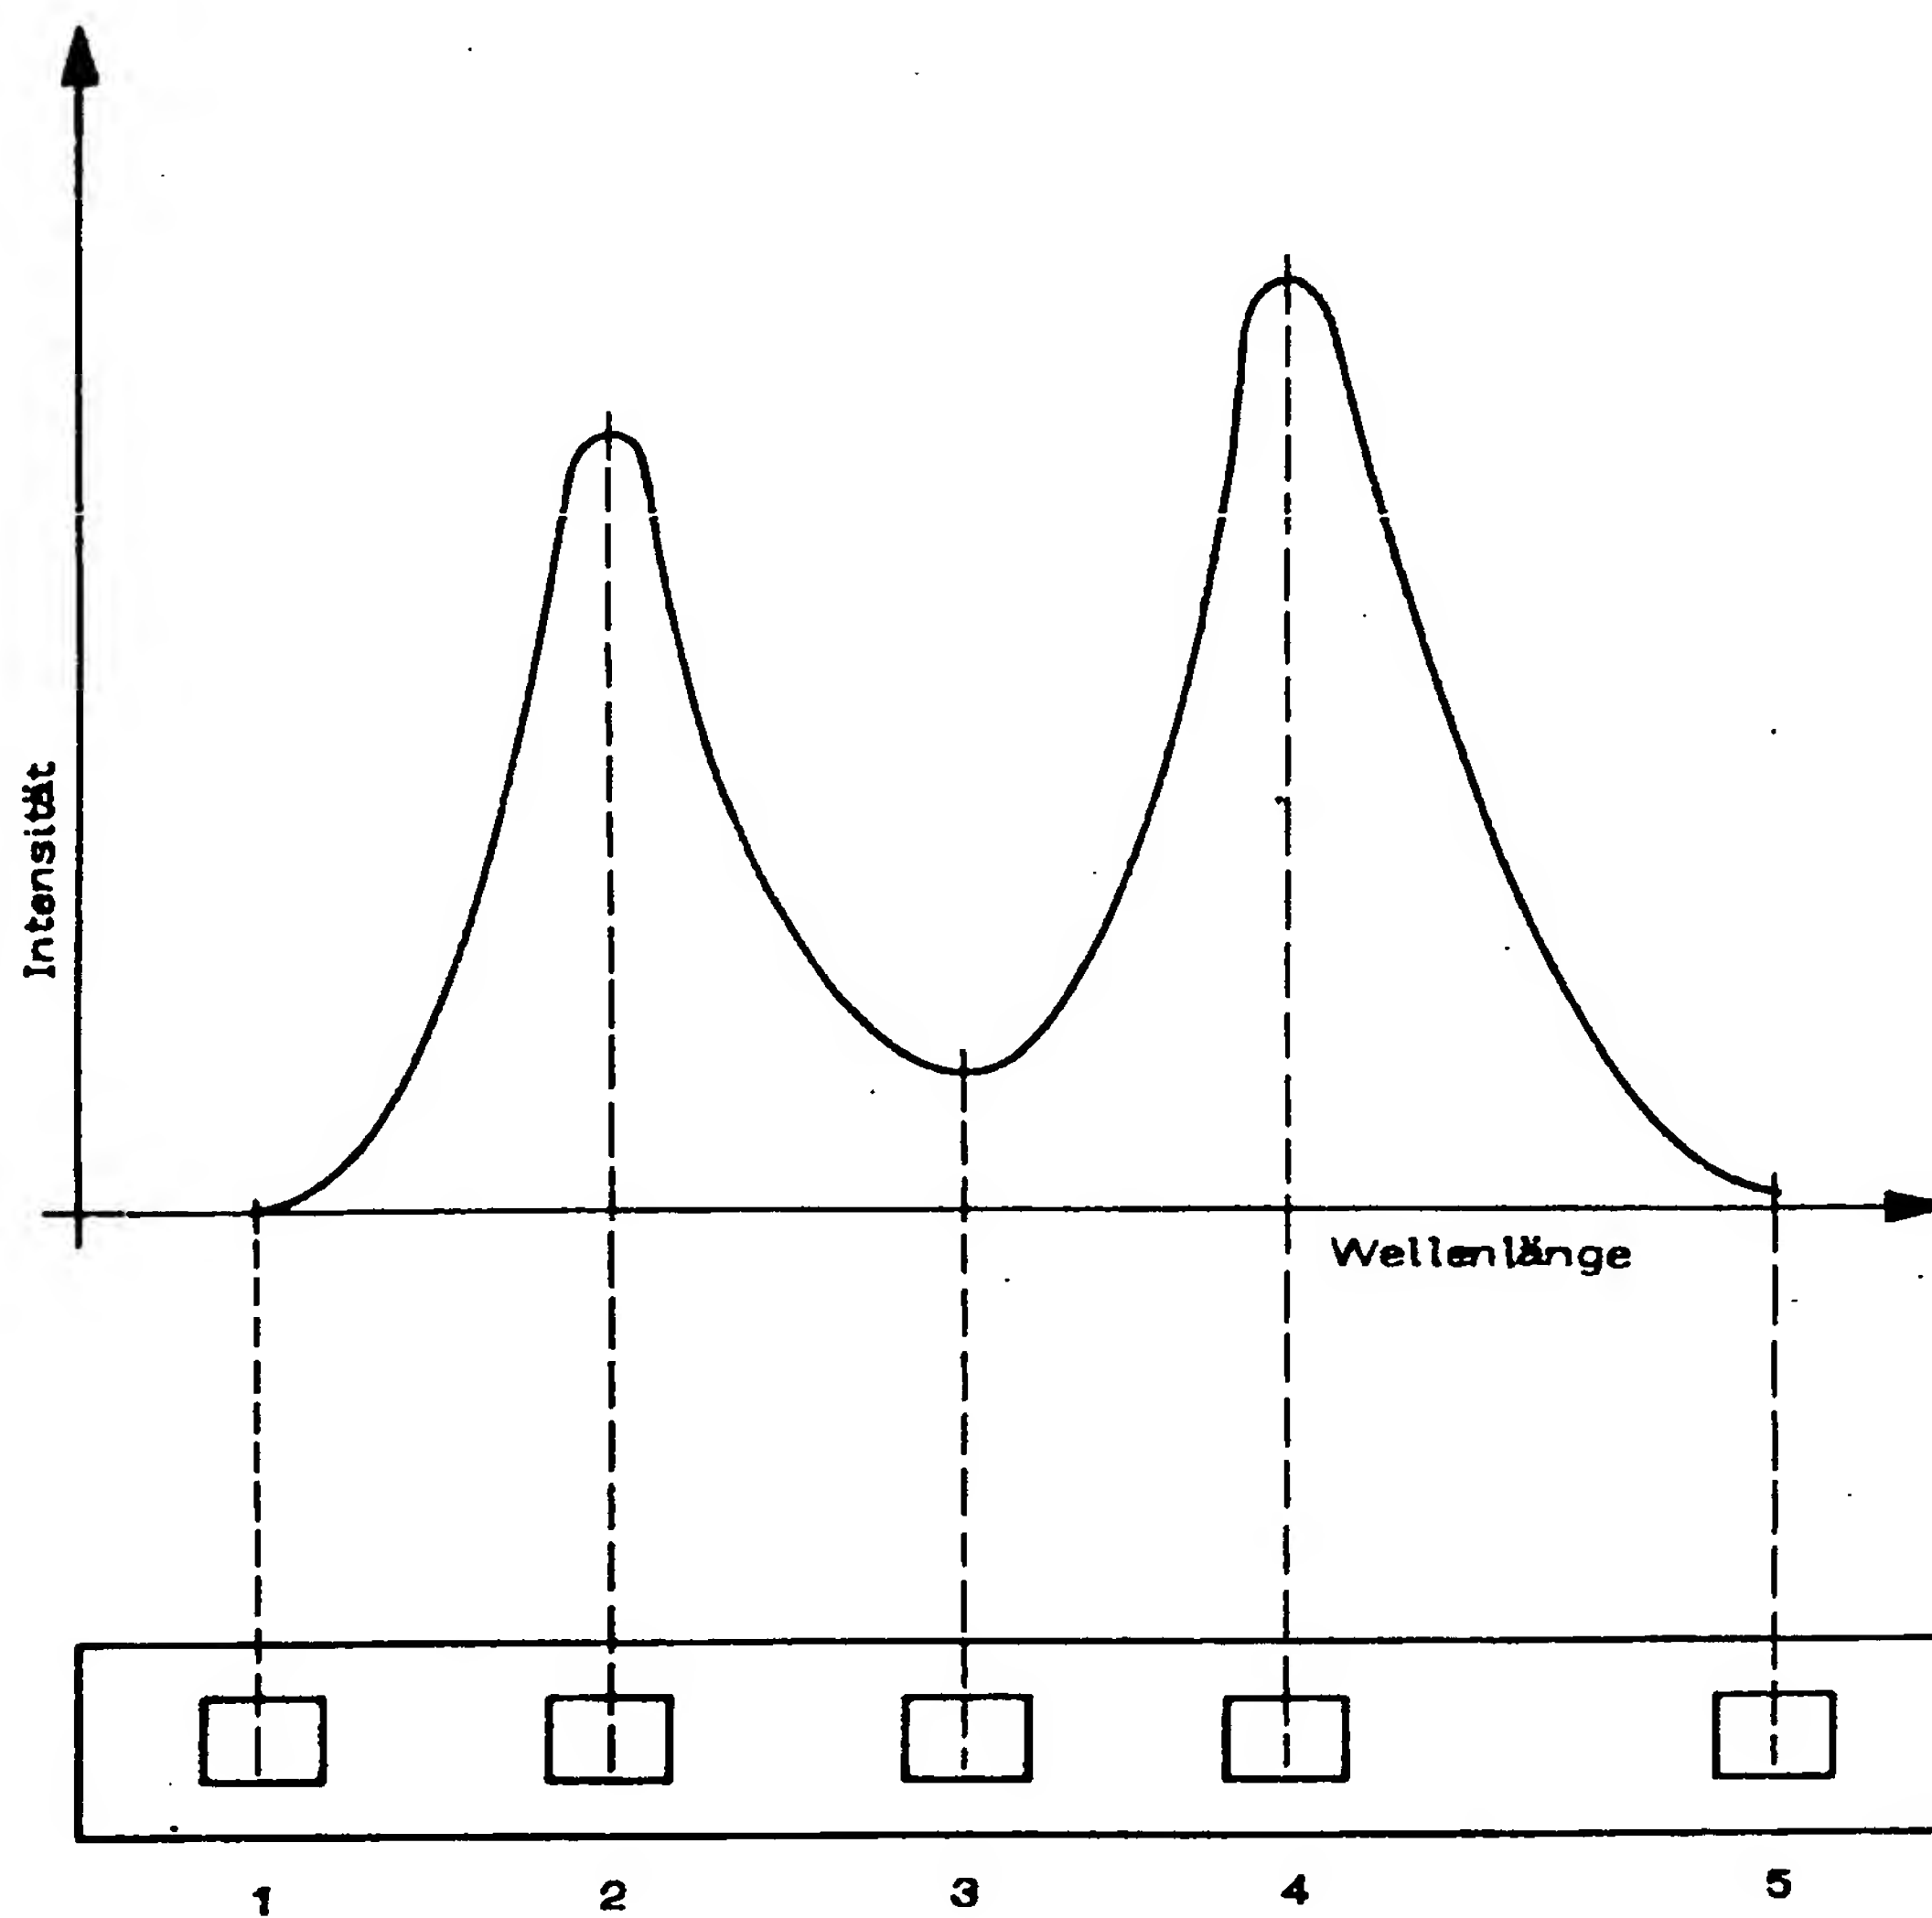


Fig. 2

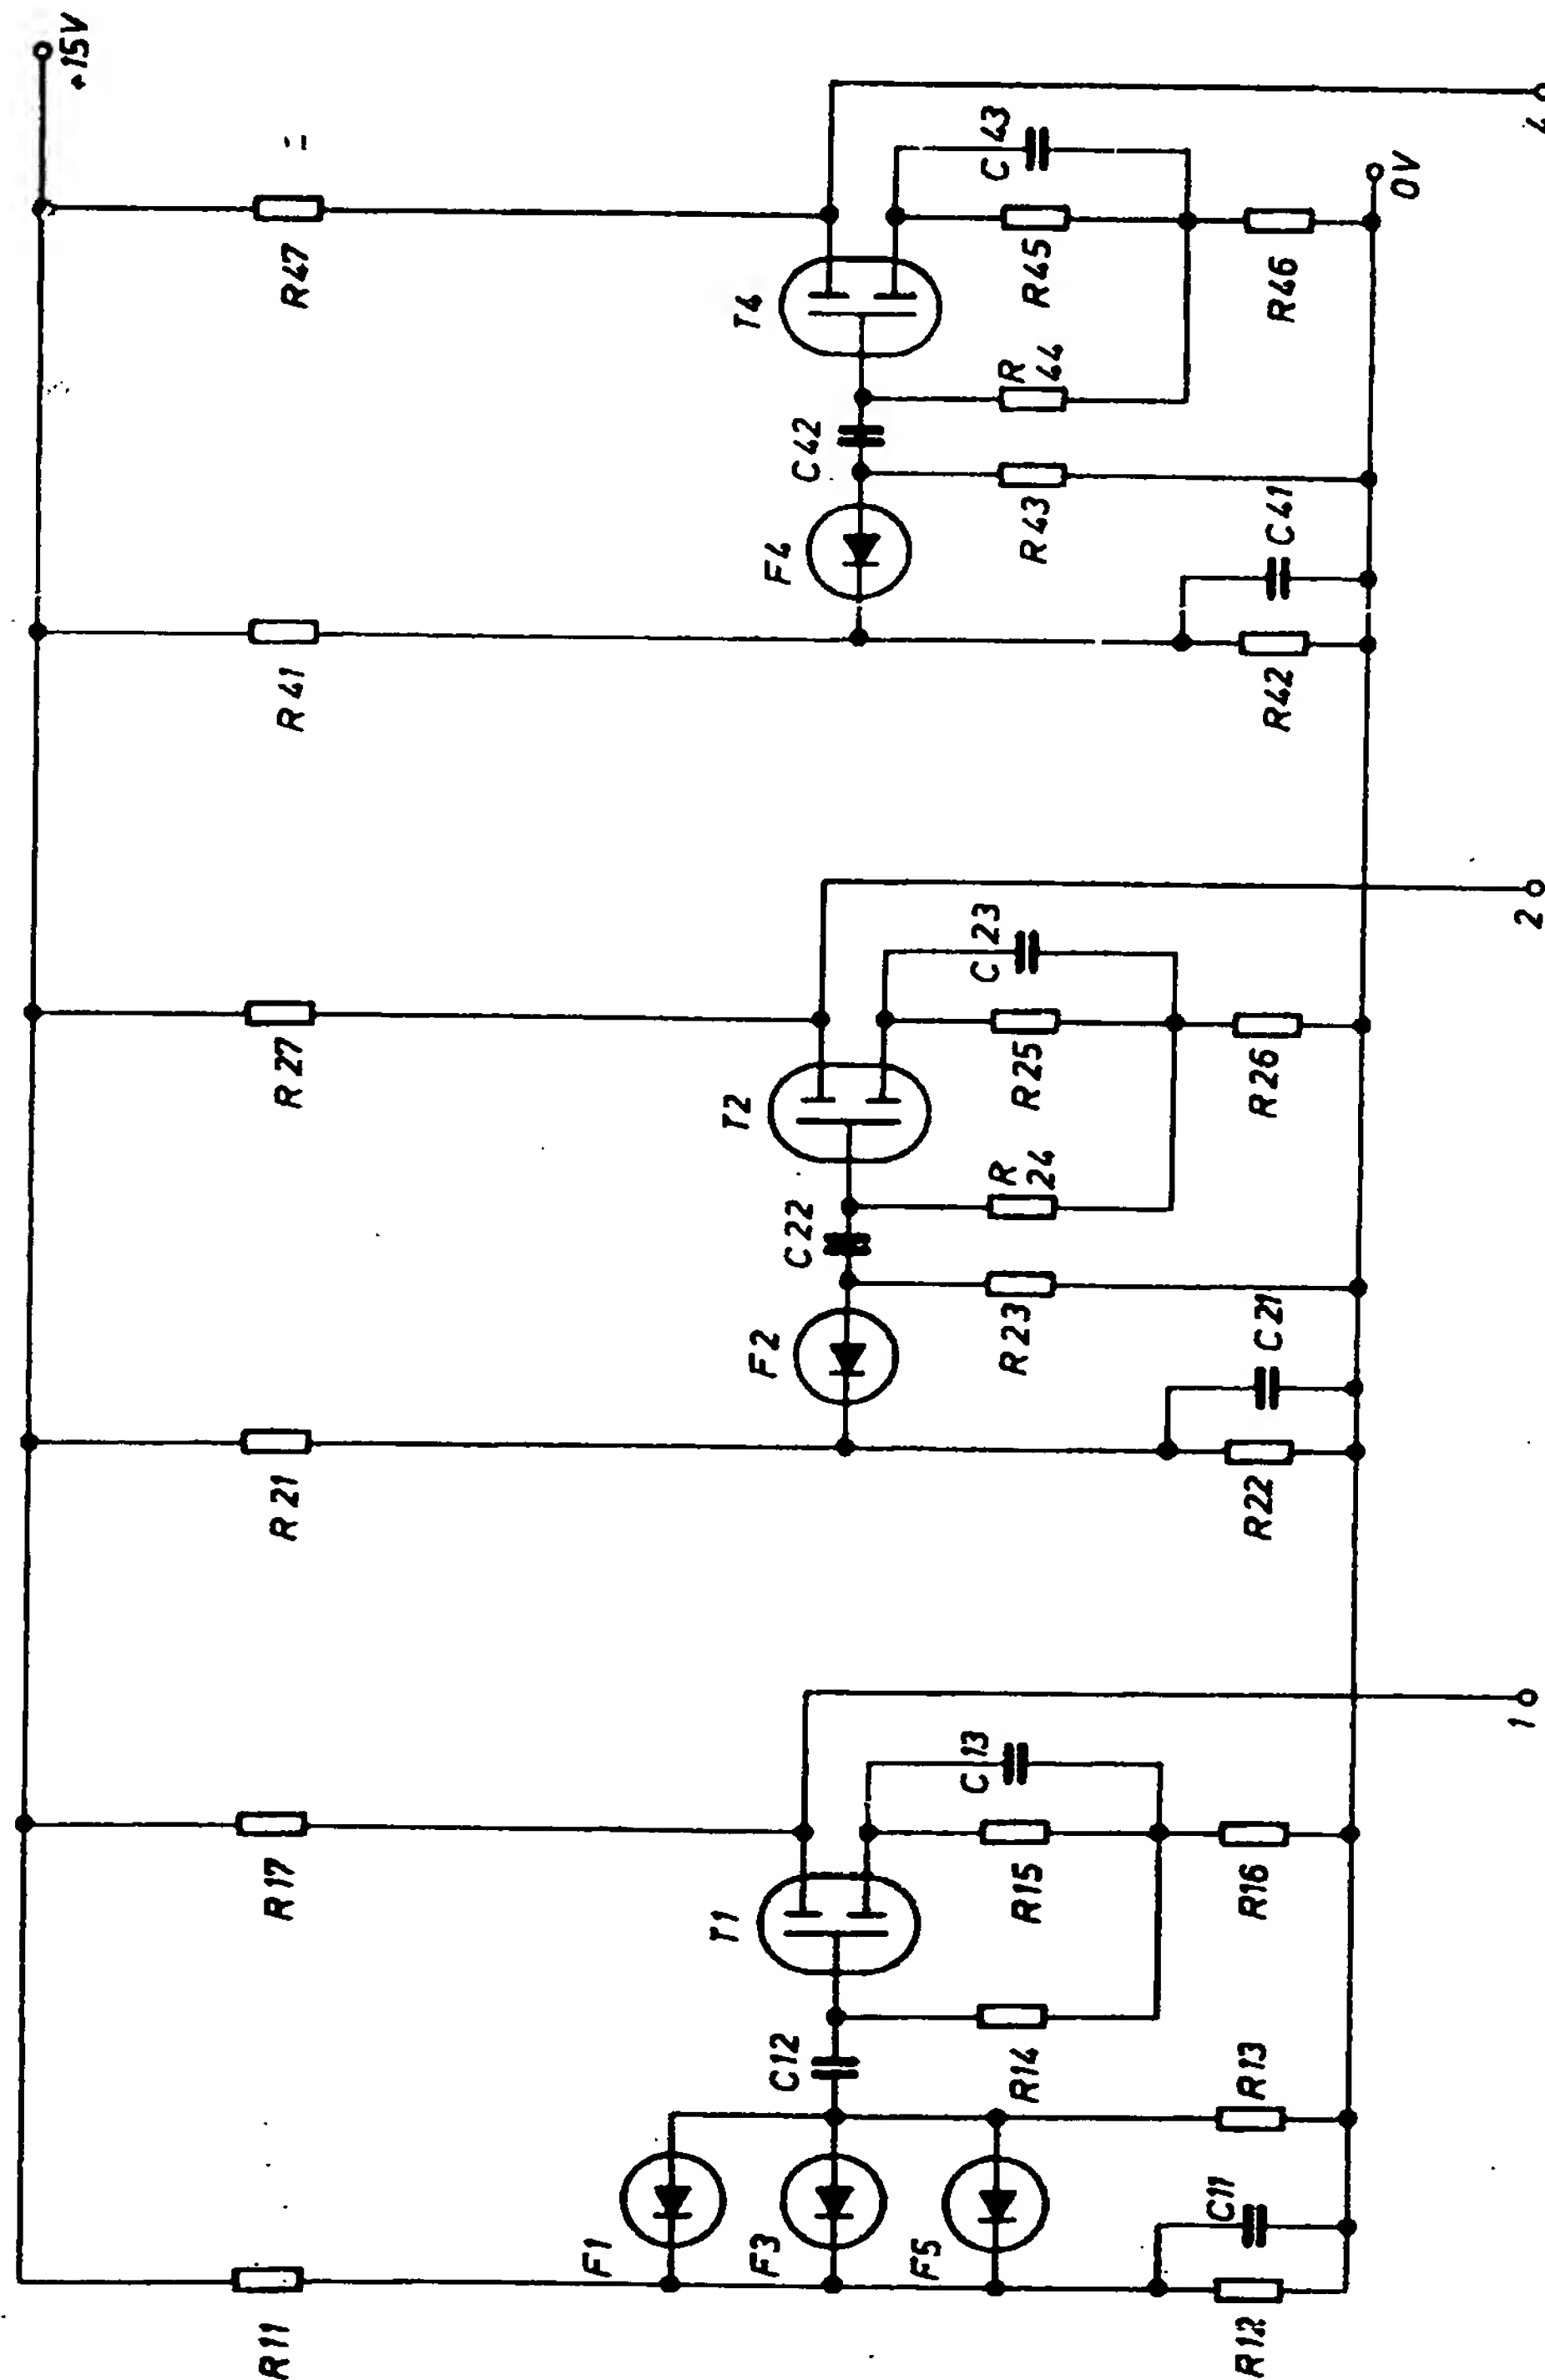


Fig.3

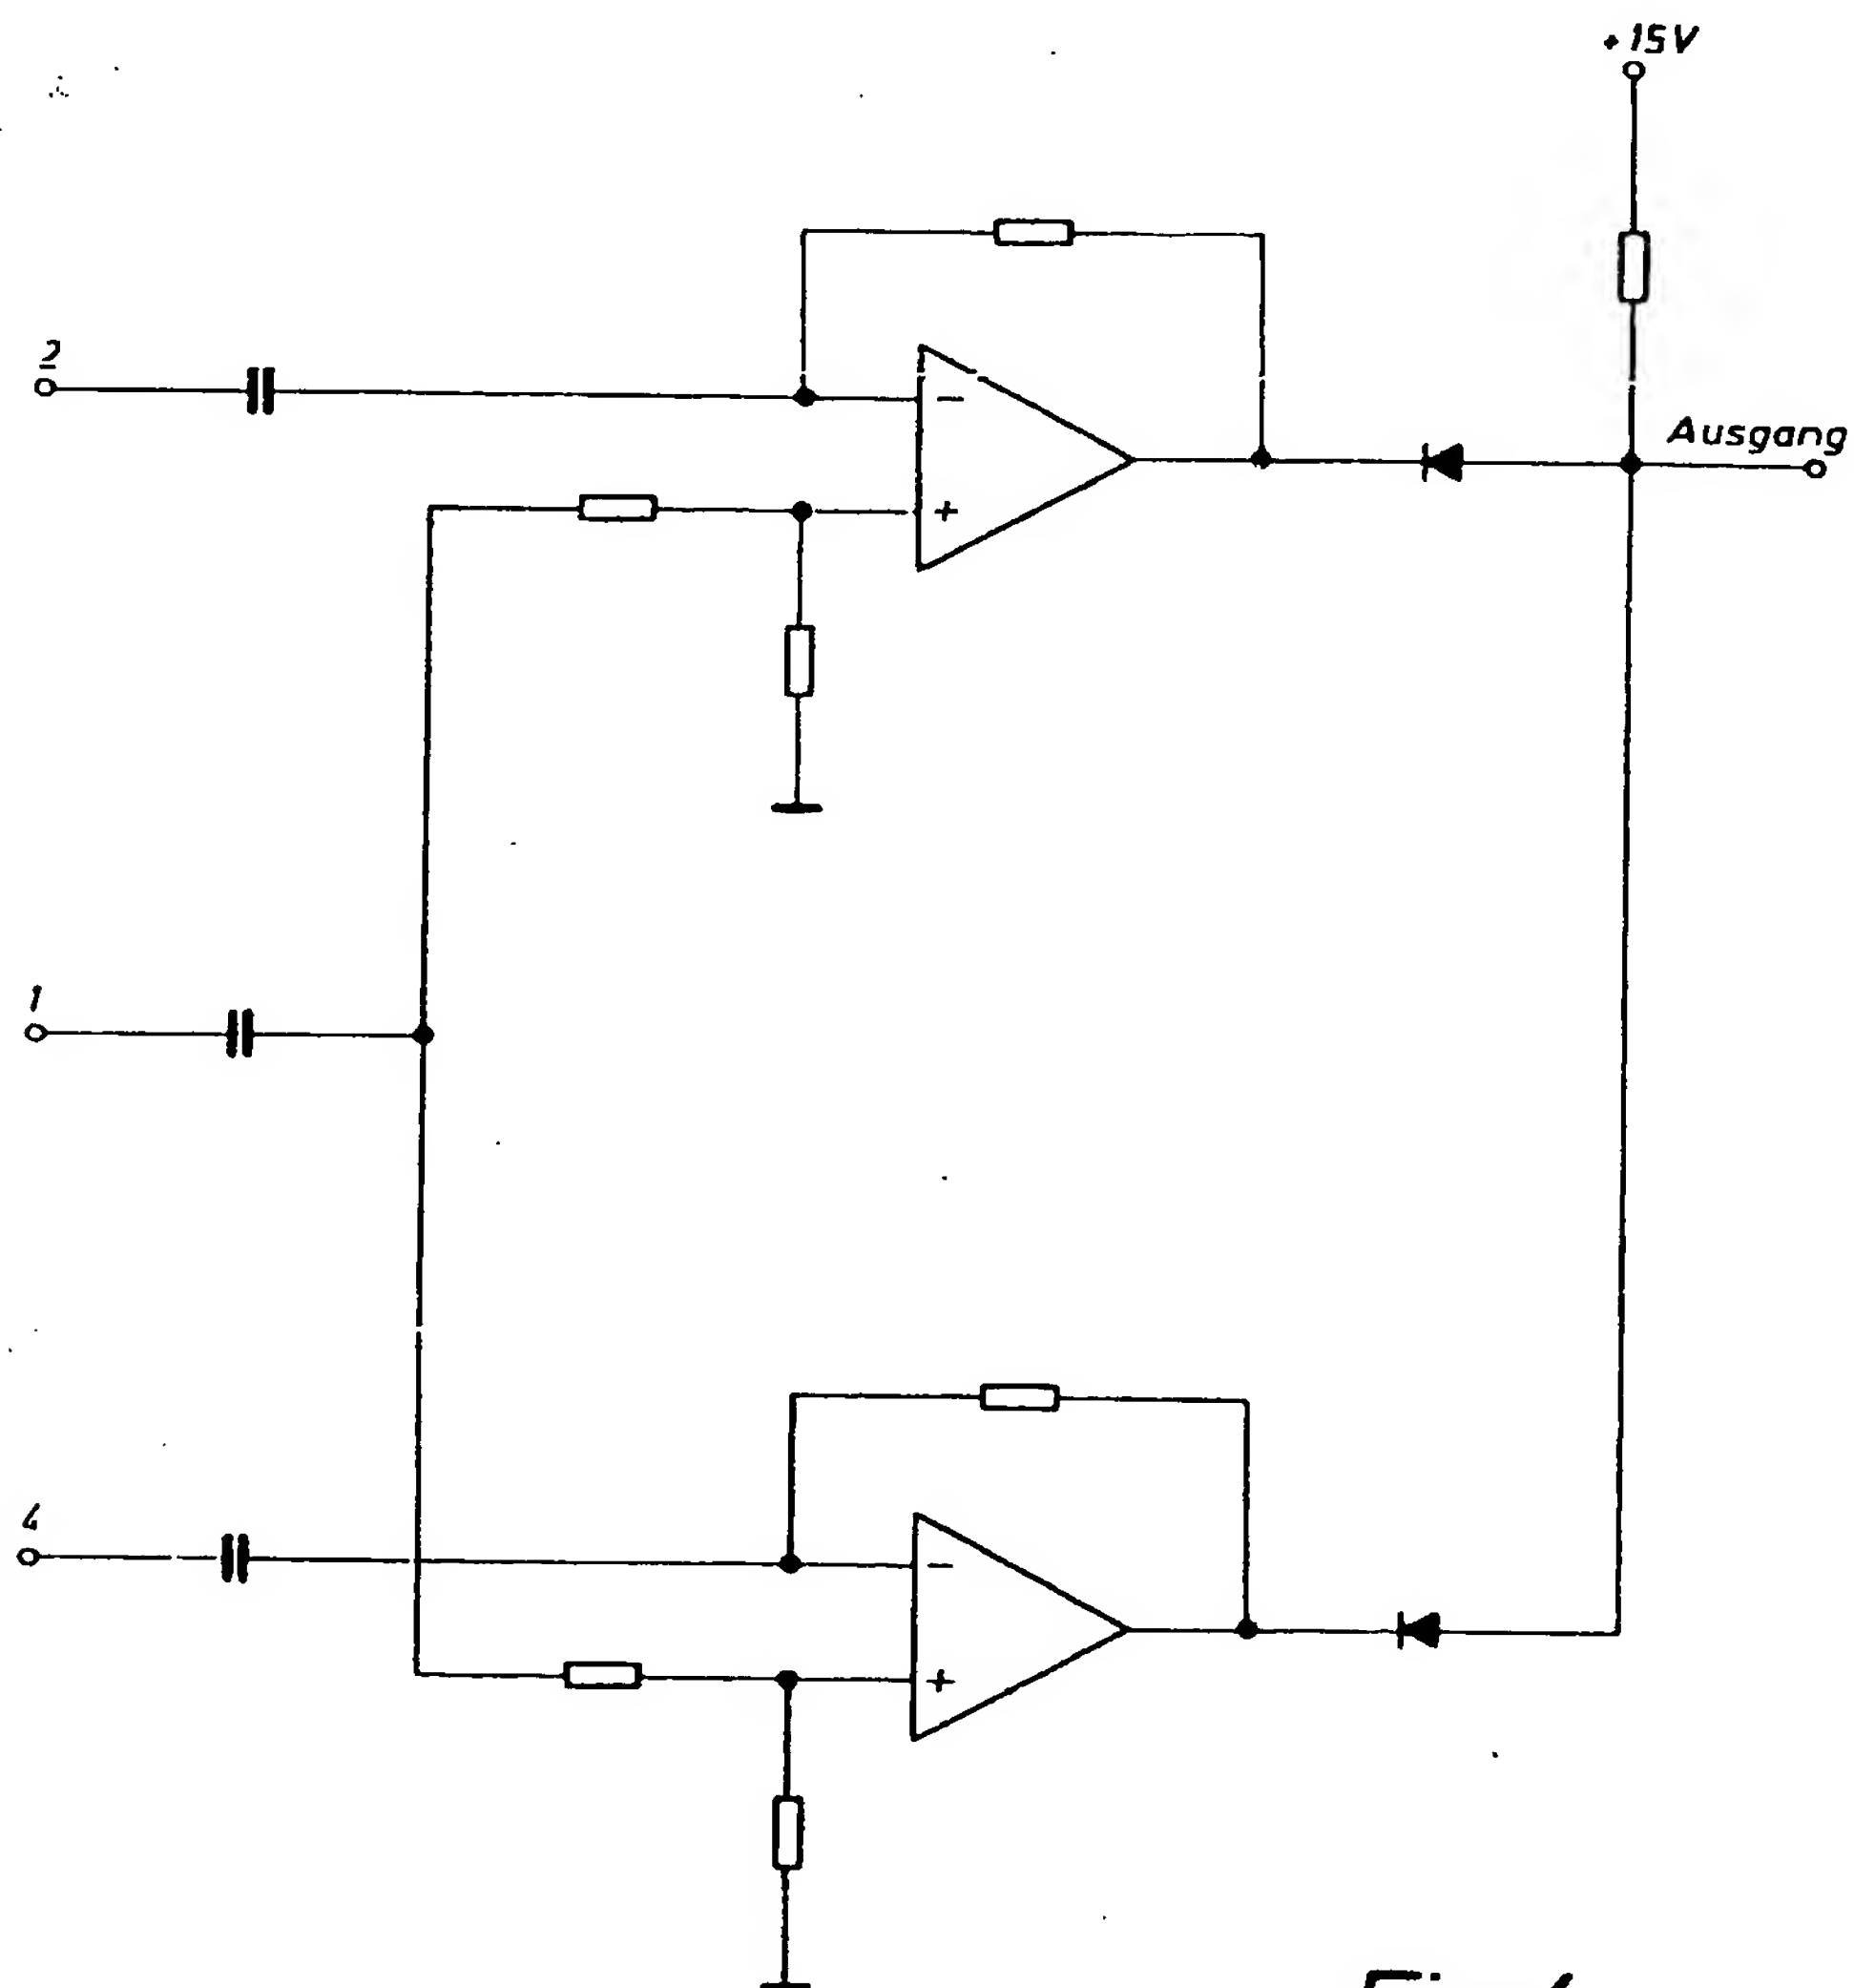


Fig.4

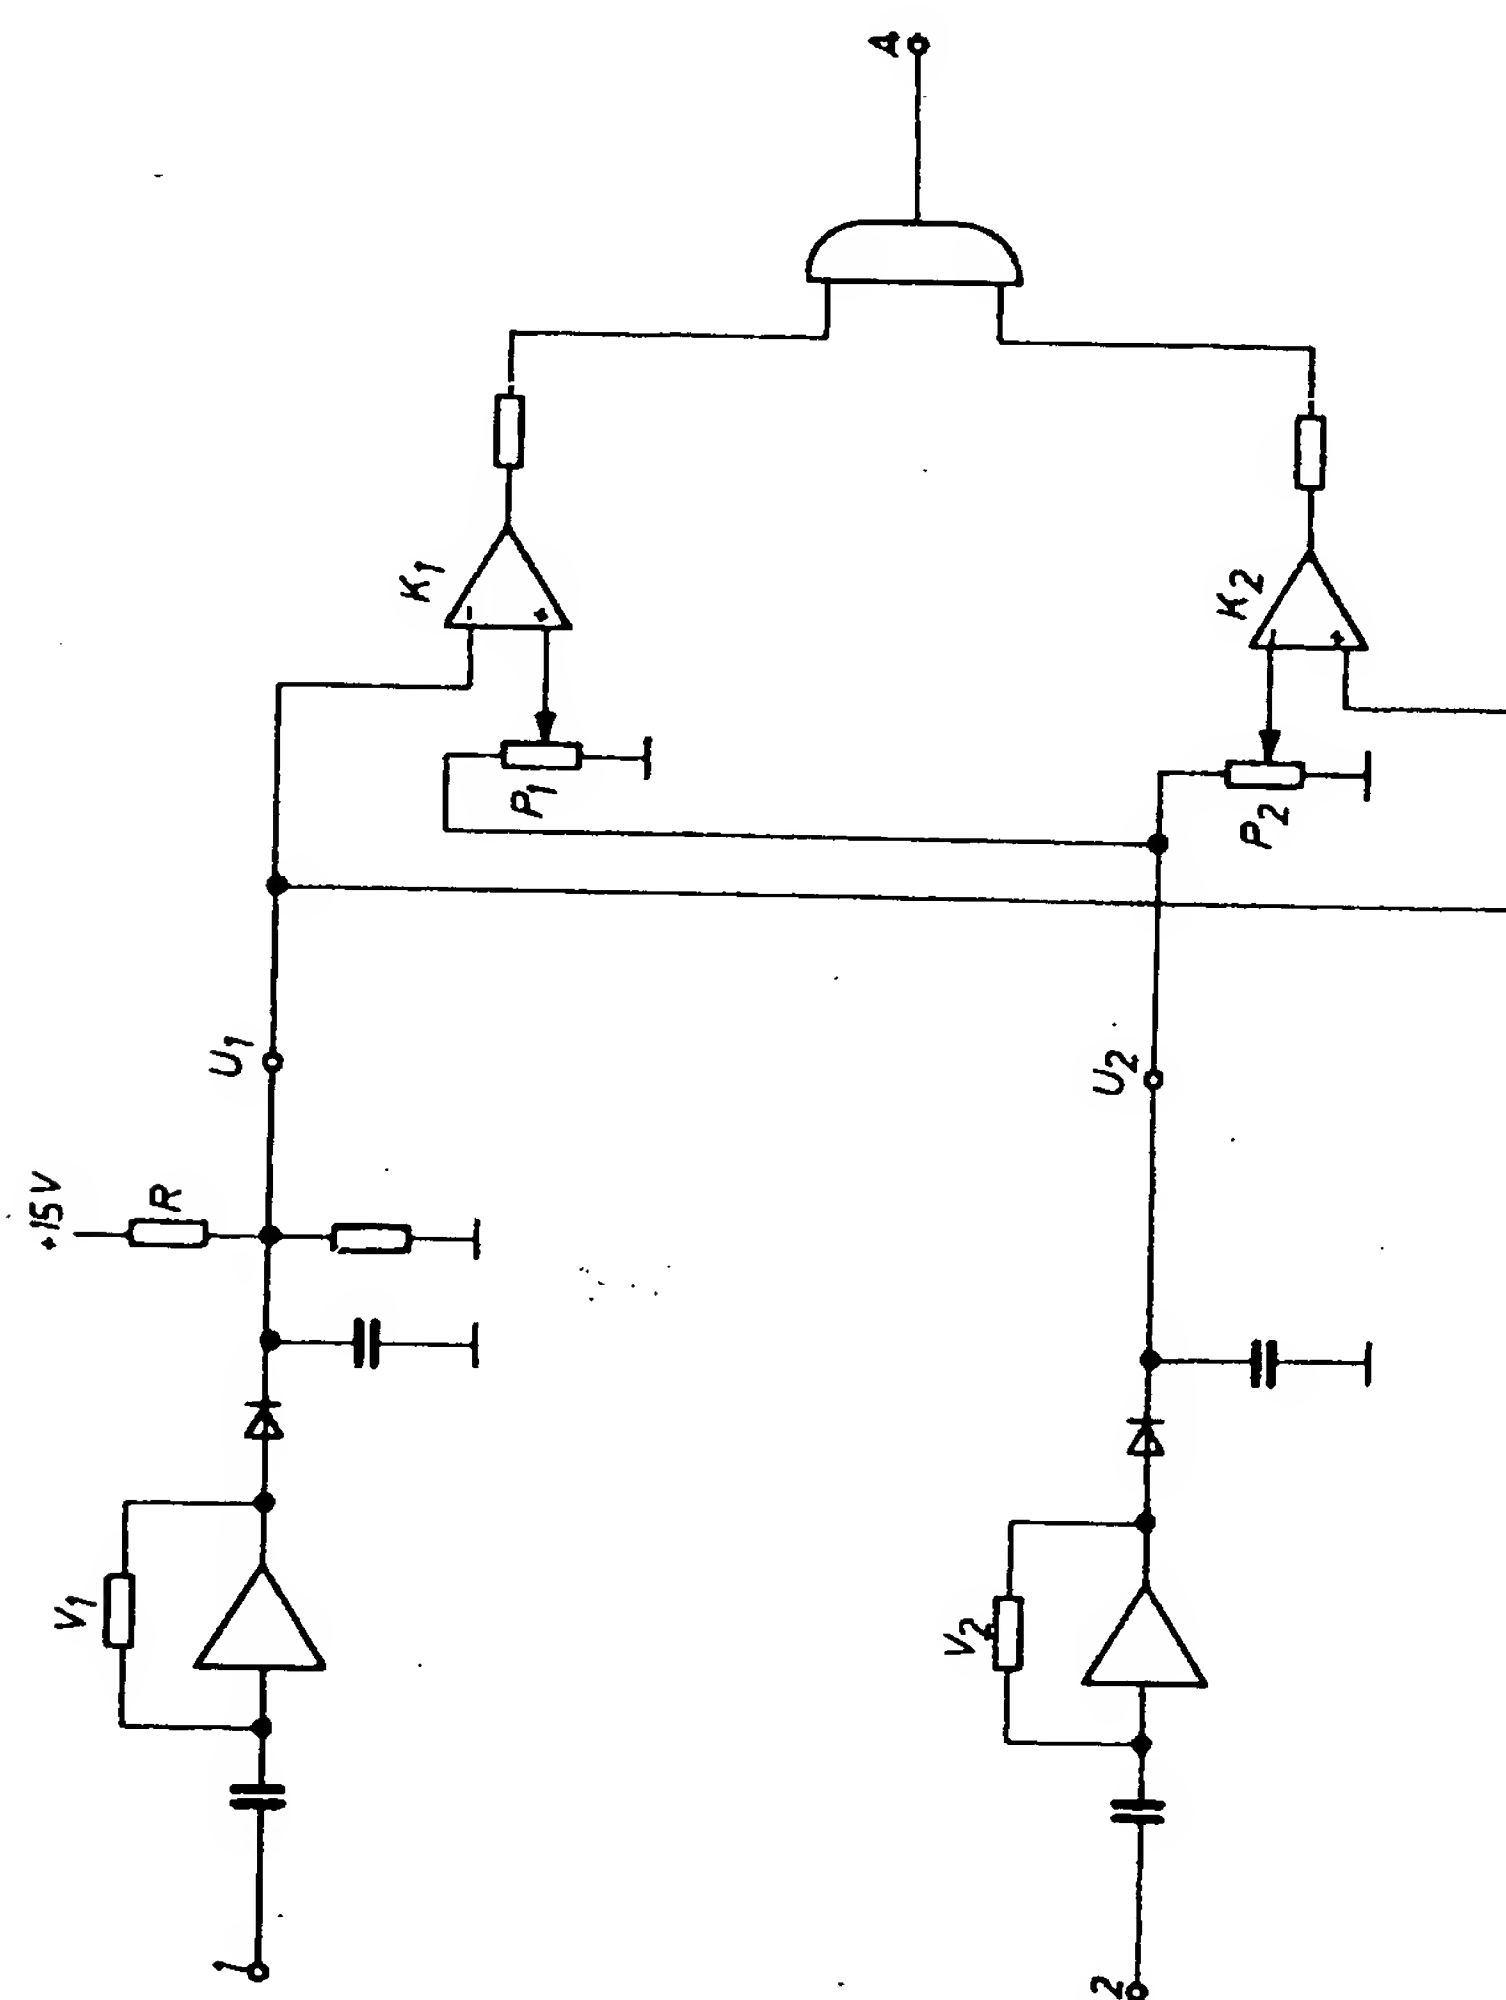


Fig. 5

Deutsches
Patent- und Markenamt



DEPATISnet

Einsteiger

Experte

Ikofax

Familie

Assistent

> DEPATISnet-Startseite > Recherche > Familie > Trefferliste

Trefferliste

Suchanfrage:

de2366274

TREFFERLISTE: TREFFER: 15 (GESAMTTREFFER: 15) ANGEZEIGTE TREFFERLISTE HERUNTERLADEN				
Nr.	Veröffentlichungs- Nummer ▲	Titel	Anzeige PDF	Familien- Recherche
1	AT000000335205B	[DE] EINRICHTUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG VON WERTPAPIEREN		Suchen
2	AT000000330574B	[DE] FALSCHUNGSGESICHERTES WERTPAPIER		Suchen
3	BE000000813821A	[EN] Casting base for metallurgical vessels [FR] SIEGE DE COULEE POUR ...		Suchen
4	CH000000559946A			Suchen
5	DE000007315547U1	[DE] PRUEFGERAET		Suchen
6	DE000002366274C2	[DE] Prüfgerät zum Prüfen der Echtheitsmerkmale in Wertpapieren oder ...		Suchen
7	DE000002320731C3			Suchen
8	DE000002320731B2	[DE] FAELSCHUNGSGESICHERTES WERTPAPIER		Suchen
9	DE000002320731A	[] FAELSCHUNGSGESICHERTES WERTPAPIER UND EINRICHTUNG ZUR ECHTHEITSPRUEFUNG ...		Suchen
10	FR000002187994B1			Suchen
11	FR000002187994A1			Suchen
12	GB000001439173A	[EN] SECURITY PAPER AND DEVICE FOR CHECKING THE AUTHENTICITY OF SUCH ...		Suchen
13	IT000000986638B	[] CARTA VALORE PREMUNITA CONTRO LE FALSIFICAZIONI E DISPOSITIVO PER ...		Suchen
14	SE000000407953C	[] FORFALSKINGSSEKRAT VERDEPAPPER		Suchen
15	SE000000407953B	[] FORFALSKINGSSEKRAT VERDEPAPPER		Suchen

[|<](#)
[<](#)
[>](#)
[>|](#)
[Drucken](#)
[Zurück zur Recherche](#)



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.